



SNAP™ Combo
English version

The SNAP Combo FeLV Ag/FIV Antibody Test is a rapid immunoassay for simultaneous detection of feline leukemia virus (FeLV) antigen and antibody to feline immunodeficiency virus (FIV) in feline serum, plasma or whole blood. The presence of FeLV p27 antigen is diagnostic for FeLV infection, and the presence of specific antibodies to FIV indicates that a cat has been exposed to FIV and may have an active FIV infection.

Precautions and warnings

- All wastes should be properly decontaminated prior to disposal.
- Do not mix components from kits with different serial numbers.
- Do not use a SNAP device that has been activated prior to the addition of sample.
- Refer to country specific Safety Data Sheet for regional hazard identification.

Storage

Store devices and test reagents at 2–8°C until the expiration date. All components must be at room temperature (18–25°C) before running the test—**do not heat**.

Kit components

Item	Reagents	Quantity
1	1 bottle anti-FeLV and FIV: HRPO conjugate (Preserved with ProCin™ 150)	8.0 mL
2	SNAP device	5, 15 or 30
Reagents contained in each device:		
	Wash solution (preserved with ProCin™ 150)	0.4 mL
	Substrate solution	0.6 mL
Other Components: transfer pipettes, sample tubes, and reagent rack		

Conjugate - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302 + P350 / P363 / P333 + P313 / P501: May cause an allergic skin reaction. Harmful to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing mist/vapors. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. Wash contaminated clothing before reuse. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Dispose of contents/container in accordance with local / regional/national/international regulations.


Wash Solution - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305 + P351 + P338 / P337 + P313 / P333 + P313 / P363 / P501: May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid breathing mist/vapours. Wash thoroughly after handling. Contaminated work clothing must not be allowed out of the workplace. Avoid release to the environment. Wear eye protection/face protection. Wear protective gloves. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. Dispose of contents/container in accordance with local / regional/national/international regulations.

Sample information

- Samples must be at room temperature (18–25°C) before beginning the test procedure.
- Serum, plasma or anti-coagulated whole blood (e.g., EDTA, heparin), either fresh or stored at 2–8°C for up to one week, can be used.
- For longer storage, serum or plasma can be frozen (-20°C or colder) and then re centrifuged before use.
- Hemolyzed or lipemic samples will not affect results.

Test procedure


- Allow all components to equilibrate at room temperature (18–25°C) for 30 minutes before use. **Do not heat**.
- Using the pipette provided, dispense **3 drops of sample** into a new sample tube.
- Holding the bottle vertical, add **4 drops of conjugate** to the sample tube.
- Cap the sample tube and mix it thoroughly by **inverting it 3–5 times**.
- Place the device on a horizontal surface. Add the entire contents of the sample tube to the sample well, being careful not to splash the contents outside of the sample well. The sample will flow across the result window, reaching the activation circle in 30–60 seconds. Some sample may remain in the sample well.
- When color **FIRST** appears in the activation circle, push the activator firmly until it is flush with the device body.
- Test results must be read at **10 minutes** from the time of activation. **Note:** The positive control may develop sooner, but results are not complete until 10 minutes.

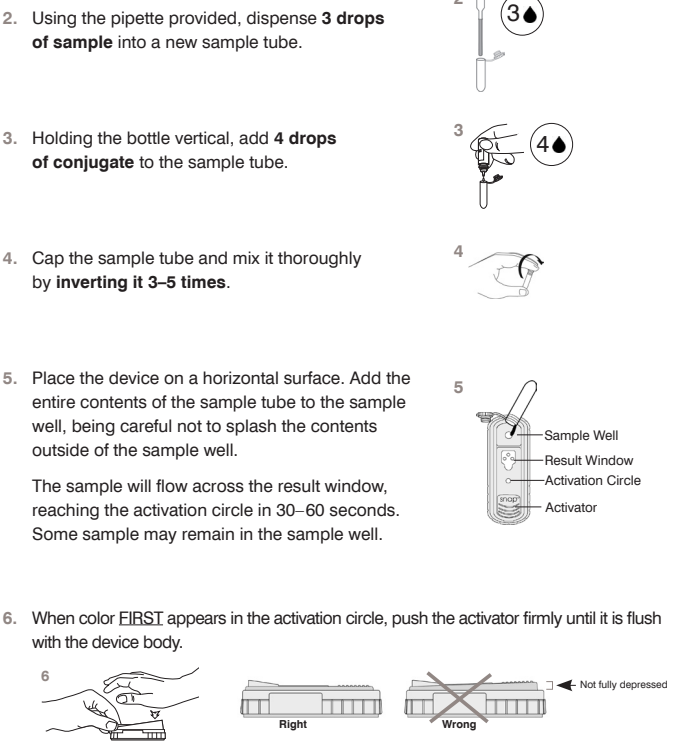

Note: Some samples may not flow to the activation circle within 60 seconds and, therefore, the circle may not turn color. In this case, press the activator after the sample has flowed across the result window.

Interpreting test results

Positive result
Any color development in the sample spots indicates the presence of FIV antibody or FeLV antigen in the sample.

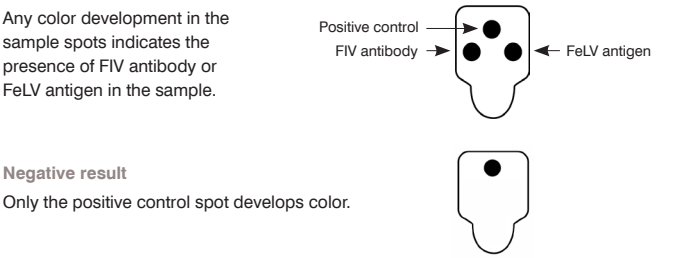

Negative result
Only the positive control spot develops color.

Invalid results

- Background**—If the sample is allowed to flow past the activation circle, background color may result. Some background color is normal. However, if colored background obscures the test result, repeat the test.
- No color development**—If the positive control does not develop color, repeat the test.

Symbol Descriptions


	Use by		Authorized representative in the European Community
	Batch code (Lot)		
	Serial number		Consult instructions for use
	Temperature limitation		In vitro diagnostic
	Manufacturer		Date of manufacture
	Catalog number		

IDEXX Technical Support
USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

VLN/PCN: 313/502A.04
SNAP is a trademark or registered trademark of IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.
Patent information: idexx.com/patents
© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 06-0021122-00



Westbrook, Maine 04092 USA
idexx.com



SNAP™ Combo
Version française

Le test Combo Ag FeLV/Ab FIV SNAP est un immunodosage rapide pour la détection simultanée d'un antigène du virus de la leucémie féline (FeLV) et d'anticorps contre le virus de l'immunodéficience féline (FIV) dans le sérum, le plasma ou le sang total félin. La présence de l'antigène p27 FeLV permet de diagnostiquer une infection au FeLV et la présence d'anticorps spécifiques au FIV indiquent que le chat a été exposé au FIV et peut présenter une infection au FIV active.

Précautions et mises en garde

- Tous les déchets doivent être décontaminés comme il se doit avant leur mise au rebut.
- Ne pas mélanger les composants de kits comportant des numéros de série différents.
- Ne pas utiliser le dispositif SNAP s'il a été activé avant que n'y soit ajouté l'échantillon.
- Se référer à la fiche de données de sécurité spécifique au pays pour identifier les dangers régionaux.

Conservation

Conserv les dispositifs et les réactifs à 2–8°C jusqu'à la date de péremption. Tous les composants doivent être à température ambiante (18–25°C) avant usage—**ne pas chauffer**.

Composants du kit

Article	Réactifs	Quantité
1	1 flacon de conjugué anti-FeLV et FIV:HRPO (Conservateur: ProCin™ 150)	8,0 ml
2	Dispositif SNAP	5, 15 ou 30
Réactifs présents dans chaque dispositif:		
	Solution de lavage (Conservateur: ProCin™ 150)	0,4 mL
	Solution de substrat	0,6 mL
Autres composants: pipettes de transfert, tubes d'échantillon, et support à réactifs		

Conjugué - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302 + P350 / P363 / P333 + P313 / P501: Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.


Solution de lavage - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305 + P351 + P338 / P337 + P313 / P333 + P313 / P363 / P501: Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs. Si les yeux sont soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales.

Informations concernant les échantillons

- Les échantillons doivent être à température ambiante (18–25°C) avant d'effectuer le test.
- Il est possible d'utiliser du sérum, plasma ou sang total sur anticoagulant (par ex., EDTA, héparine), frais ou conservé à 2–8°C pendant une semaine maximum.
- Pour une durée de conservation supérieure, il est possible de congeler le sérum ou le plasma (-20°C ou à une température inférieure) et de le centrifuger à nouveau avant l'emploi.
- Les échantillons hémolysés ou lipémiques n'affectent pas les résultats.

Procédure du test

- Laisser tous les composants s'équilibrer à température ambiante (18–25°C) pendant 30 minutes. **Ne pas chauffer**.
- À l'aide de la pipette fournie, ajouter **3 gouttes d'échantillon** dans un nouveau tube.
- Tenir le flacon à la verticale et ajouter **4 gouttes de conjugué** dans le tube.
- Reboucher le tube et mélanger soigneusement par **inversion (3 à 5 fois)**.
- Placer le dispositif sur une surface horizontale. Ajuster la totalité du contenu du tube dans le puits en évitant toute éclaboussure hors du puits. L'échantillon va s'écouler à travers la fenêtre de lecture avant d'atteindre le cercle d'activation après 30 à 60 secondes environ. Il est possible qu'une partie de l'échantillon reste dans le puits.
- Dès que le cercle d'activation **COMMENCE** à changer de couleur, enfoncer fermement l'activateur pour l'aligner avec le corps du dispositif.
- Lire les résultats du test au bout de **10 minutes**. **Remarque:** Le contrôle positif peut apparaître rapidement mais les résultats sont considérés comme définitifs qu'au bout de 10 minutes.

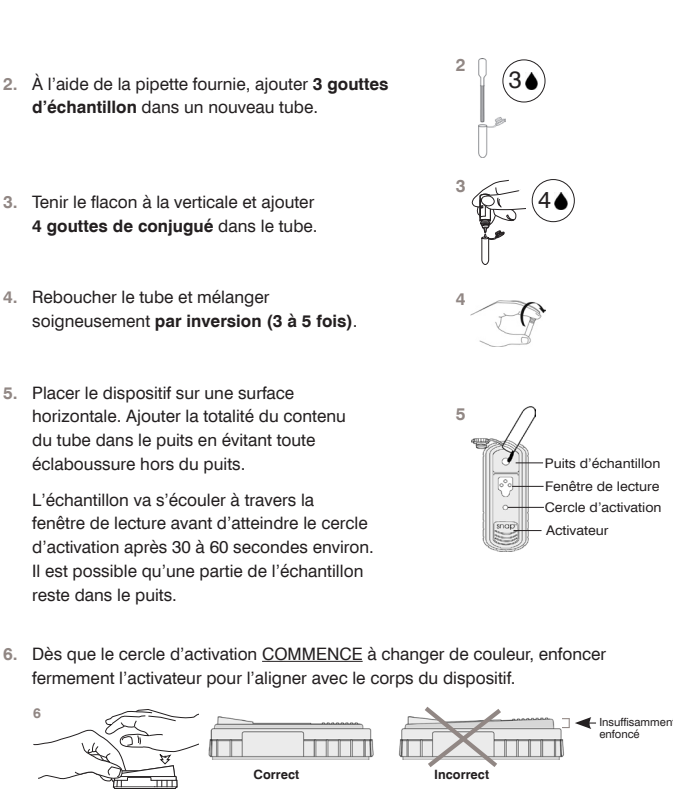

Remarque: Il est possible que certains échantillons n'atteignent pas le cercle d'activation en 60 secondes, auquel cas le cercle risque de ne pas changer de couleur. Si cela se produit, appuyer sur l'activateur une fois que l'échantillon a traversé la fenêtre de lecture.

- Lire les résultats du test au bout de **10 minutes**. **Remarque:** Le contrôle positif peut apparaître rapidement mais les résultats sont considérés comme définitifs qu'au bout de 10 minutes.

Interprétation des résultats du test

Résultat positif
Tout développement de coloration dans le cercle d'échantillon indique la présence d'anticorps du FIV ou d'antigène du FeLV dans l'échantillon.

Résultat négatif
Seul le contrôle positif change de couleur.

Résultats invalides

- Bruit de fond**—Si l'échantillon s'écoule au-delà du cercle d'activation, le fond peut se colorer. Une certaine coloration du fond est normale. Cependant, si cette coloration obscurcit les résultats du test, recommencer le test.
- Pas de coloration**—Si le contrôle positif ne se colore pas, recommencer le test.

Descriptions des symboles


	À utiliser avant la date		Représentant agréé pour la Communauté européenne
	Numéro de lot		
	Numéro de série		Consulter la notice d'utilisation
	Limite de température		Diagnostic in vitro
	Fabricant		Date de fabrication
	Numéro de catalogue		

Assistance technique IDEXX
É.-U./Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europe: idexx.eu

VLN/PCN: 313/502A.04
SNAP est une marque de commerce ou une marque déposée d'IDEXX Laboratories, Inc. ou ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Information sur les brevets: idexx.com/patents
© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés.



Westbrook, Maine 04092 USA
idexx.com



SNAP™ Combo
Deutsche Version

Der SNAP Combo FeLV Ag/FIV-Antikörpertest ist ein schneller Immunoassay zum gleichzeitigen Nachweis des feline Leukämievirus (FeLV)-Antigens und von Antikörpern gegen das feline Immunodefizienzvirus (FIV) in Serum, Plasma oder Vollblut von Katzen. Das Vorhandensein des FeLV-p27-Antigens ist diagnostisch für eine FeLV-Infektion, und das Vorhandensein spezifischer Antikörper gegen FIV weist darauf hin, dass eine Katze FIV ausgesetzt war und möglicherweise eine aktive FIV-Infektion hat.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

- Alle Abfallstoffe müssen vor der Entsorgung ordnungsgemäß dekontaminiert werden.
- Komponenten aus Kits mit unterschiedlichen Chargenbezeichnungen nicht zusammen verwenden.
- Wenn eine SNAP Testeinheit vor Zugabe der Probe aktiviert wurde, darf sie nicht verwendet werden.
- Für die regionale Gefahrenidentifikation verweisen wir auf das länderspezifische Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung

Testeinheiten und Reagenzien sind bis zum Verfalldatum bei 2–8°C zu lagern. Alle Bestandteile müssen Raumtemperatur (18–25°C) erreicht haben, bevor der Test durchgeführt wird. **Nicht erhitzen!**

Kitkomponenten

Artikel	Reagenzien	Menge
1	1 Flasche (Anti-FeLV und FIV:HRPO)-Konjugat (Konservierungsstoff: ProCin™ 150)	8,0 ml
2	SNAP Testeinheit	5, 15 oder 30
In jeder Testeinheit enthaltene Reagenzien:		
	Waschlösung (Konservierungsstoff: ProCin™ 150)	0,4 ml
	Substratlösung	0,6 ml
Sonstige Komponenten: Transferpipetten, Probenröhrchen und Reagenzständer		

Konjugat - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302 + P350 / P363 / P333 + P313 / P501: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Nebel/Dampf/Vermeiden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.


Waschlösung - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305 + P351 + P338 / P337 + P313 / P333 + P313 / P363 / P501: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Einatmen von Nebel/Dampf/Vermeiden. Nach Handhabung Hände gründlich waschen. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behütet mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Angaben zum Probenmaterial

- Proben müssen Raumtemperatur (18–25°C) erreicht haben, bevor das Prüfverfahren beginnt.
- Serum, Plasma oder ungeronnenes Vollblut (z. B. EDTA, Heparin), das entweder frisch ist oder bei 2–8°C bis zu einer Woche gelagert wurde, kann verwendet werden.
- Zur längeren Lagerung kann Serum oder Plasma eingefroren (-20°C oder kälter) und dann vor dem Einsatz erneut zentrifugiert werden.
- Hämolyisierte oder lipämische Proben beeinträchtigen die Testergebnisse nicht.

Testverfahren

- Alle Reagenzien vor Gebrauch 30 Minuten auf Zimmertemperatur (18–25°C) erwärmen lassen. **Nicht erhitzen**.
- Mit der im Lieferumfang enthaltenen Pipette **3 Probentropfen** in ein neues Probenröhrchen pipettieren.
- Die Flasche senkrecht halten und **4 Tropfen Konjugat** in das Probenröhrchen hinzugeben.
- Das Probenröhrchen verschließen und **3- bis 5-mal umdrehen**, um den Inhalt gut zu vermischen.
- Die Testeinheit auf eine ebene Fläche legen. Den gesamten Inhalt des Probenröhrchens in die Probenvertiefung geben. Darauf achten, dass der Inhalt nicht außerhalb der Probenvertiefung spritzt.
- Die Probe fließt nun über das Auswertfenster und erreicht nach ca. 30-60 Sekunden den Aktivierungskreis. Es ist möglich, dass etwas Probe in der Probenvertiefung zurückbleibt.
- SOBALD** sich der Aktivierungskreis zu verfärben beginnt, den Aktivator fest eindrücken, bis er auf gleicher Ebene mit dem Körper der Testeinheit ist.
- Nach 10 Minuten** das Testergebnis ablesen. **Hinweis:** Der Farbpunkt der positiven Kontrolle kann sich bereits früher färben, das endgültige Testergebnis liegt jedoch erst nach 10 Minuten vor.

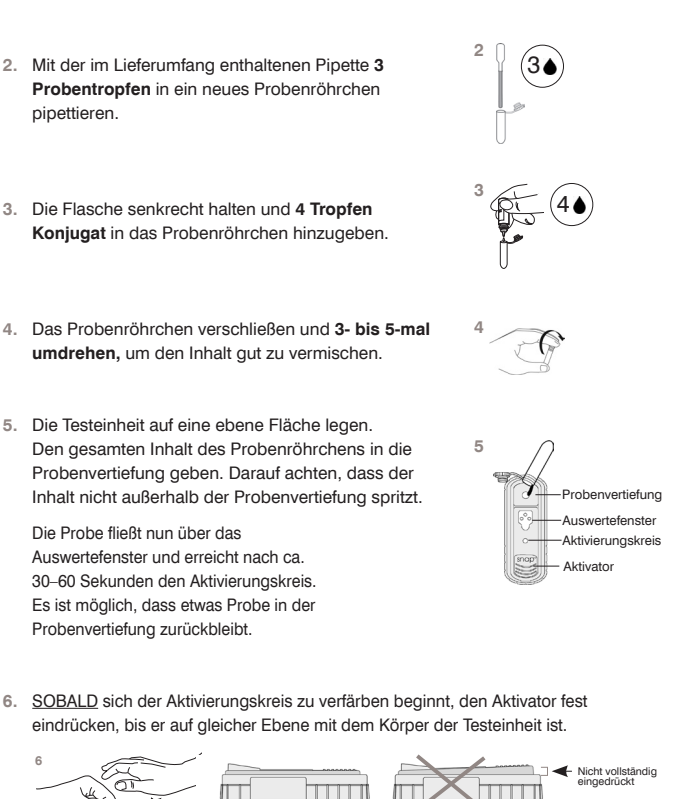

Hinweis: Manchmal fließen Proben nicht innerhalb von 60 Sekunden zum Aktivierungskreis und der Kreis nimmt eventuell keine Färbung an. In diesem Fall ist der Aktivator zu drücken, wenn die Probe über das Auswertfenster geflossen ist.

Testinterpretation

Positive Ergebnisse
Jede Farbentwicklung in den Probenanzeigen zeigt die Präsenz von FIV-Antikörpern bzw. FeLV-Antigen in der Probe an.

Negative Ergebnisse
Nur der positive Kontrollbereich entwickelt eine Färbung.

Ungültige Ergebnisse

- Hintergrund**—Wenn die Probe über den Aktivierungskreis hinaus läuft, kann sich ein Hintergrundfarbe ergeben. Etwas Hintergrundfarbe ist normal. Wenn jedoch ein farbiger Hintergrund das Testergebnis verdeckt, ist der Test zu wiederholen.
- Keine Farbentwicklung**—Wenn sich keine Färbung bei der positiven Kontrolle einstellt, ist der Test zu wiederholen.

Symbol-Beschreibungen


	Verwendbar bis		Autorisierte EG-Vertretung
	Charakterbezeichnung (Ch.-B.)		
	Numéro de serie		Gebrauchsinformation beachten
	Zulässiger Temperaturbereich		In-vitro-Diagnostikum
	Hersteller		Herstellungsdatum
	Katalognummer		

Assistenza tecnica di IDEXX
USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com
Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au
Europa: idexx.eu

VLN/PCN: 313/502A.04
SNAP ist eine Schutzmarke oder eine eingetragene Schutzmarke von IDEXX Laboratories, Inc. oder eines Tochterunternehmens von IDEXX in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
Patentinformation: idexx.com/patents
© 2025 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Westbrook, Maine 04092 USA
idexx.com



SNAP™ Combo
Versión Española

El test SNAP Combo Ag FeLV/Anticuerpo FIV es un rápido inmunoensayo para la detección simultánea de antígeno del virus de la leucemia felina (FeLV) y de anticuerpo frente al virus de la inmunodeficiencia felina (FIV) en suero felino, plasma o sangre entera. La presencia del antígeno p27 del FeLV permite diagnosticar una infección por FeLV mientras que la presencia de anticuerpos específicos frente al FIV indica que el gato ha estado expuesto al FIV y que puede tener una infección activa por FIV.

Precauciones y advertencias

- Todo desecho debe ser descontaminado apropiadamente antes de su eliminación.
- No mezclar componentes de kits con diferentes números de lote.
- No usar un dispositivo SNAP que haya sido activado antes de haber añadido de una muestra.
- Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales específica del país para identificación de peligros regionales.

Almacenamiento

Almacenar los dispositivos y los reactivos de la prueba a 2–8°C hasta la fecha de caducidad. Antes de realizar el test todos los componentes deben estar a temperatura ambiente (18–25°C). **No calentar**.

Componentes del kit

Artículo	Reactivos	Cantidad
1	1 frasco de conjugado anti-FeLV y FIV:HRPO (Conservado con ProCin™ 150)	8,0 ml
2	Dispositivo SNAP	5, 15 ó 30
Reactivos contenidos en cada dispositivo:		
	Solución de lavado (Conservada con ProCin™ 150)	0,4 ml
	Solución sustrato	0,6 ml
Otros componentes: Pipetas de transferencia, tubos de muestra y rejilla de reactivos		

Conjugado - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302 + P350 / P363 / P333 + P313 / P501: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar la niebla/los vapores. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes de protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Eliminar el contenido/ recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Solución de lavado - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305 + P351 + P338 / P337 + P313 / P333 + P313 / P363 / P501: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar respirar la niebla/los vapores. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar protección ocular/ facial. Llevar guantes de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. Lavar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. Eliminar el contenido/ recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o internacional.

Información de muestras

- Las muestras deben estar a temperatura ambiente (18–25°C) antes de comenzar el procedimiento de análisis.
- Se puede usar suero, plasma o sangre total anticoagulada (p. ej., EDTA, heparina), ya sea fresca o almacenada a 2–8°C durante una semana como máximo.
- Para un almacenamiento más prolongado, el suero o el plasma puede congelarse (-20°C, o a temperatura más fría). Habrá que volver a centrifugarlo antes de usarlo.
- Las muestras hemolizadas, ictericas o lipémicas no afectarán los resultados del análisis.

	Kit per il rilevamento dell'antigene del virus della leucemia felina e degli anticorpi contro il virus dell'immunodeficienza felina	
	Esclusivamente per uso veterinario.	

SNAP™ Combo	Versione Italiana
--------------------	--

Il test SNAP Combo FelV Ag/FIV Antibody è un immunosaggio rapido per la rievazione simultanea dell'antigene del virus della leucemia felina (FeLV) e degli anticorpi contro il virus dell'immunodeficienza felina (FIV) nel siero, plasma o sangue intero flebo. La presenza dell'antigene p27 del FeLV è diagnostica per l'infezione da FeLV, mentre la presenza di anticorpi specifici contro il FIV indica che è stato esposto al FIV e potrebbe avere un'infezione da FIV attiva.

Precauzioni e avvertenze

- Tutti i rifiuti devono essere sottoposti a opportuna decontaminazione prima dello smaltimento.
- Non mescolare componenti di kit che presentino diversi numeri di lotto.
- Non usare un dispositivo SNAP che sia stato attivato prima di inserirvi un campione.
- Fare riferimento alla scheda di sicurezza specifica del paese per l'identificazione dei pericoli regionali.

Conservazione

Conservare i dispositivi e i reagenti per il test a 2–8 °C fino alla data di scadenza. Prima di eseguire il test, tutti i componenti devono essere a temperatura ambiente (18–25 °C) — **non riscaldare**.

Componenti del kit

Articolo	Reagentes	Quantità
1	1 fialonc di coniugato anti-FelV e FIV-HRPO (conservato con ProCli™ 150)	8,0 ml
2	Dispositivi SNAP	5, 15 o 30
Reagenti contenuti in ciascun dispositivo:		
	Soluzione di lavaggio (conservata con ProCli™ 150)	0,4 ml
	Soluzione substrato	0,6 ml

Altri componenti: pipette di trasferimento, provette per campione e una rastrelliera per reagenti

	Coniugato - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302+P350 / P363 / P333+P313 / P501: Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la nebbia/vapori. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti protettivi. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle; consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in ottempinanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.	
	Soluzione di lavaggio - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305+P351+P338 / P337+P313 / P333+P313 / P363 / P501: Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare la nebbia/v vapori. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non disperdere nell'ambiente. Proteggere gli occhi. Indossare guanti protettivi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il prodotto/recipiente in ottempinanza alle norme locali/regionali/nazionali/internazionali.	
	ATTENZIONE	

Informazioni sul campione

- I campioni devono trovarsi a temperatura ambiente (18-25°C) prima di iniziare la procedura dei test.
- Siero, plasma o sangue intero fluido per aggiunta di anticoagulante (per es., EDTA,eparina) possono essere impiegati freschi o conservati a temperature comprese tra 2–8 °C per un periodo massimo di una settimana.
- Per poterli conservare più a lungo, siero o plasma possono essere congelati (−20 °C o a temperatura inferiore), quindi devono essere centrifugati di nuovo prima del loro impiego.
- I risultati non vengono alterati utilizzando campioni emolizzati, litetici o lipemici.

Procedura del test

- Lasciare tutti i componenti a temperatura ambiente 18–25 °C per 30 minuti. **Non riscaldare**.

- Servendosi della pipetta, inserire **3 gocce di campione** in una provetta nuova.
- Tenendo il fialonc in posizione verticale, aggiungere **4 gocce di coniugato** alla provetta.
- Mettere il tappo sulla provetta e mescolare accuratamente **capovolgendola da 3 a 5 volte**.
- Collocare il dispositivo su una superficie piana. Trasferire tutto il contenuto della provetta nel pozzetto del campione, prestando attenzione a non far schizzare il contenuto al di fuori del pozzetto. Il campione fluisce attraverso la finestra dei risultati, raggiungendo il cerchio di attivazione in circa 30–60 secondi. Parte del campione potrebbe rimanere nel pozzetto del campione.
- APPENA** il colore compare nel cerchio di attivazione, premere l'attivatore con fermezza fino a quando non si trova a filo con il corpo del dispositivo.

Importante: alcuni campioni potrebbero non fluire nel cerchio di attivazione entro 60 secondi; di conseguenza il cerchio potrebbe non cambiare colore. In questo caso, premere l'attivatore dopo che il campione è passato attraverso la finestra dei risultati.

- Leggere il risultato del test trascorsi **10 minuti**.

Nota: il punto del controllo positivo potrebbe svuipparsi prima, ciononostante l'esito dell'esame non è da considerarsi definitivo prima che siano trascorsi 10 minuti.

Interpretazione dei risultati del test

Risultati positivi

Lo sviluppo di colore nei punti campione indica la presenza della FIV o dell'antigene della FeLV nel campione.

				
Risultati negativi				
Solo la machia del controllo positivo sviluppa il colore.				

Risultatis non validi

- Sfondo**—Se si lascia fluire il campione oltre il cerchio di attivazione, lo sfondo può sviluppere colore. Sviluppo di colore sullo sfondo in quantità ridotta è normale. Tuttavia, se il colore dello sfondo impedisce di leggere i risultati, ripetere il test.
- Nessuno sviluppo di colore**—Se il controllo positivo non sviluppa colore, ripetere il test.

				
Descrizione dei simboli				
	Usare entro		ECREP	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
[LOT]	Codice del lotto (partita)			
[S]	Numero di serie		[I]	Consultare le istruzioni per l'uso
	Limite di temperatura		[VD]	Diagnostico in vitro
	Ditta produttrice			Data di produzione
[REF]	Numero di catalogo			

	Assistenza tecnica IDEXX		IDEXX Technische ondersteuning		
	USA/Canada: 1 800 248 2483 • idexx.com		VS/Canada 1 800 248 2483 • idexx.com		
	Australia: 1300 44 33 99 • idexx.com.au		Australië: 1300 44 33 99 • idexx.com.au		
	Europa: idexx.eu		Europa: idexx.eu		

				
IDEXX		IDEXX		IDEXX

SNAP è un marchio di proprietà di, o registrato da, IDEXX Laboratories, Inc. o dei suoi affiliati e protetto negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Informazioni sui brevetti: idexx.com/patents.
NL-2130 EK Hoofddorp IDEXX.com

	Feline Leukemie Virus Antigen-Feline Immunodeficiëntie Virus Antichaan Test Kit	
	Enkel voor veterinair gebruik.	

SNAP™ Combo	Nederlandse Versie
--------------------	---

De SNAP Combo FelV Ag/FIV Antichaan test is een snelle immunoassay voor gelijktijdige detectie van feline leukemie virus (FelV) antigen en antichaan tegen het feline immunodeficiëntie virus (FIV) in feline serum, plasma of volbloed. De aanwezigheid van FelV p27 is diagnostisch voor FelV infectie, en de aanwezigheid van specifieke antichaan tegen FIV geeft aan dat de kat blootgesteld is geweest aan FIV en mogelijk een actieve FIV infectie heeft.

Voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen.

- Alle afval dient behoorlijk ontsmet te worden alvorens het wordt afgevoerd.
- Geen onderdelen van kits met verschillende partijnnummers door elkaar gebruiken.
- Geen SNAP-instrument gebruiken dat geactiveerd is voordat een monster wordt toegevoegd.
- Raadpleeg het landspecifieke veiligheidsinformatieblad voor de identificatie van regionale gevaaren.

Opslag

SNAP-instrumenten en testreagentia moeten bij 2–8 °C worden bewaard. Alle onderdelen moeten op kamertemperatuur (18–25 °C) zijn voordat de test wordt uitgevoerd - **NIE** VERWARMEN.

Kitonderdelen

Artikel	Reagens	Hoeveelheid
1	1 fles anti-FelV en FIV: HRPO-coniugaat (Geconserveerd met ProCli™ 150)	8,0 ml
2	SNAP-instrument	5, 15 of 30
Reagentia in elk instrument:		
	Spoelvoelstof (Geconserveerd met ProCli™ 150)	0,4 ml
	Substraatvoelstof	0,6 ml
Overige onderdelen:	transferpipetten, buisjes en reagensrek	

	Coniugaat - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302+P350 / P363 / P333+P313 / P501: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inadering van nevel/dampnen vermijden. Verontreinigde werkkleding mag de werkkuimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen dragen. BI CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.	
	Spoelvoelstof - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305+P351+P338 / P337+P313 / P333+P313 / P363 / P501: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige ogeniratie. Schadelijk voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Inadering van stof/rookgias/ nevel/dampnen/peutere mist, is niet toegestaan. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Verontreinigde werkkleding mag de werkkuimte niet verlaten. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogenscherming/geschltaatsbescherming dragen. BI CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.	
	WAARSCHUWING	

Monsterinformatie

- De monsters moeten op kamertemperatuur (18–25 °C) zijn voordat met de testprocedure wordt begonnen.
- Er kan serum, plasma of ontkost vol bloed (bv., EDTA, heparine) worden gebruikt, hetzij vers of maximaal één week oud indien bij 2–8 °C bewaard.
- Voor langere bewaring kunnen serum en plasma worden bevroren (−20° of kouder), maar dient de serum of plasma opnieuw te worden gecentrifugeerd voor gebruik.
- Gehemolyseerde, icterische of lipemische monsters hebben geen invloed op het testresultaat.

Testproedure

- Laat alle componenten op kamertemperatuur (18–25 °C) komen voor gebruik gedurende 30 minuten. **Niet verwarmen**.
- Met de meegeleverde pipet **3 druppels monster** in een nieuw monsterbuisje doseren.
 -
 -
 -
 -
 -
- Tewijv u het flesje verticaal houdt **4 druppels coniuugaat** aan het testbuisje toevoegen.
- De dop op het monsterbuisje zetten en de inhoud grondig mengen door het buisje **3-5 keer om te draaien**.
- Het instrument op een horizontaal oppervlak zetten. De hele inhoud van het monsterbuisje aan de monsterholte toevoegen, waarbij u ervoor opzatt dat u de inhoud ervan niet buiten de monsterholte laat spatten.

Holte voor monsters

Resultaatvenster

Actieveercirkel

Activator
- Als de activator **VOOR HET EERST** kleur in de actieveercirkel verschijnt, stevig op de activator drukken totdat deze gelijk is met de behuizing van het instrument.
 -
 -
 -
 -
 -
 -

NB: Sommige monsters stromen niet binnen 60 seconden naar de actieveercirkel en het kan dus zijn dat er geen kleur in de cirkel verschijnt. In dat geval op de activator drukken nadat het monster langs het resultaatvenster is gestroomd.

Interpreteren van de testresultaten

Positief resultaat
Iedere kleurontwikkeling op de plakken van de cirkels voor het monster geeft de aanwezigheid van FelV antichaan of FeLV antigen aan in het monster.

				
Negatief resultaat				
Er ontwikkelt zich alleen kleur in de positieve controle.				

- Ongedile resultaten
- Achtergrond**—Als u het monster voorbij de actieveercirkel laat stromen, kan er achtergrondkleur ontstaan. Een beetje achtergrondkleur is normaal. Als de gekleurde achtergrond echter het testresultaat onduidelijk maakt, dient u de test te herhalen.
 - Geen kleurontwikkeling**—Als de positieve controle geen kleur ontwikkelt, dient u de test te herhalen.

Symbolomschrijvingen

	Houdbaar tot		ECREP	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
[LOT]	Batch Code (lot)			
[S]	Serienummer		[I]	Raadpleeg handleiding voor gebruik
	Temperatuurgrenzen		[VD]	Voor in-vitrodiagnostiek
	Fabrikant			Datum van vervaardiging
[REF]	Catalogusnummer			

	Popis symbolů		Popisní výsledek		
	Datum minimální trvanlivosti		ECREP	Pověřené zástupce v Evropském společenství	
[LOT]	Číslo šarže (výrobní dávky)				
[S]	Výrobní číslo		[I]	Nahledněte do návodu k použití	
	Teplotní omezení		[VD]	Diagnostika in-vitro	
	Výrobce			Datum výroby	
[REF]	Katalogové číslo				

	Popis symbolů		Popisní výsledek		
	Datum minimální trvanlivosti		ECREP	Pověřené zástupce v Evropském společenství	
[LOT]	Číslo šarže (výrobní dávky)				
[S]	Výrobní číslo		[I]	Nahledněte do návodu k použití	
	Teplotní omezení		[VD]	Diagnostika in-vitro	
	Výrobce			Datum výroby	
[REF]	Katalogové číslo				

SNAP is een merk danwel een geregistreerd merk van IDEXX Laboratories, Inc. of haar filialen in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Patentinformatie: idexx.com/patents.
NL-2130 EK Hoofddorp IDEXX.com

	Testovací souprava na průkaz antigenu viru leukémie koček / protilátěk proti viru imunodeficienci koček	
	Jen pro veterinární použití.	

SNAP™ Combo	Česká verze
--------------------	----------------------------------

SNAP Combo FelV Ag/FIV Antibody Test je rychlý imunotest pro současnou detekci antigenu viru kočičí leukémie (FeLV) a protilátek proti viru kočičí imunodeficiency (FIV) v kočičím séru, plazmě nebo plně krvi. Přítomnost antigenu FelV je diagnostická pro infekci FeLV a přítomnost specifických protilátek proti FIV ukazuje, že kočka byla vystavena FIV a může mít aktivní infekci FIV.

Bezpečnostní opatření a upozornění

- Všechny odpady je nutné před odstráněním řádně dekontaminovat.
- Nemíchejte součásti z různých výrobních šarží testovacích souprav.
- Nepoužívejte SNAP-test, který byl aktivován před přidáním vzorku.
- Nepoužívejte SNAP-tester, který byl používán před přidáním vzorku.
- Oblastní identifikaci nebezpečí naleznete v bezpečnostním listu jednotlivých zemí.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2–8 °C až do data expirace. Všechny součásti musejí mít před provedéním testu pokojovou teplotu (18–25 °C) — **Nezahřívajte**.

Součásti testovací soupravy

Položka	Reagencie	Množství
1	1 lahvička anti-FelV a FIV: konjugát HRPO (konzervovaný pomocou ProCli™ 150)	8,0 ml
2	SNAP-test	5, 15 nebo 30
Reagencie obsažené v každem teste:		
	Premývací roztok (konzervovaný pomocou ProCli™ 150)	0,4 ml
	Roztok substrátu	0,6 ml
Další součásti:	dávkovací pipety, zkumavky na vzorky a stojánek na reagencie	

	Konjugát - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302+P350 / P363 / P333+P313 / P501: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamete vychováním řmů/pap. Kontaminovaný pracovní oděv neodnádejte z pracoviště. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PR STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mydla. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperete. Ak sa prejaví podráždené pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/oleštenie. Pri podráždení kože nebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/oleštenie. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/sátních/mezinárodních předpisů.	
	Konjugát - H317 / H402 / H412 / P261 / P272 / P273 / P280 / P302+P350 / P363 / P333+P313 / P501: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamete vychováním řmů/pap. Kontaminovaný pracovní oděv neodnádejte z pracoviště. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PR STYKU S KŮŽÍ: Omyte velkým množstvím vody a mydla. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperete. Pri podráždení kože nebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/oleštenie. Pri podráždení kože nebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/oleštenie. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionalních/sátních/mezinárodních předpisů.	
	Premývací roztok - H317 / H319 / H402 / H412 / P261 / P264 / P272 / P273 / P280 / P305+P351+P338 / P337+P313 / P333+P313 / P363 / P501: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždení očí. Škodlivý pro vodní organismy. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamete vychováním řmů/pap. Po manipulaci starostlivo umyj ruce. Je zakázáno vstoupit kontaminovaný pracovní oděv z pracoviště. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné, odstráňte ich. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Pokud je to možné, vyberte oči zpravidla vyčistěte vyfukovacími vzduchy. Zabráte uvolnění do životního prostředí. Nosíte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PR ZASAŽENÍ OČÍ: Neškodně omyjte oči. Pokud je to možné	